


試料サンプル測定結果

八王子市保健所

測定日付 : 2015-10-22-13:53:46

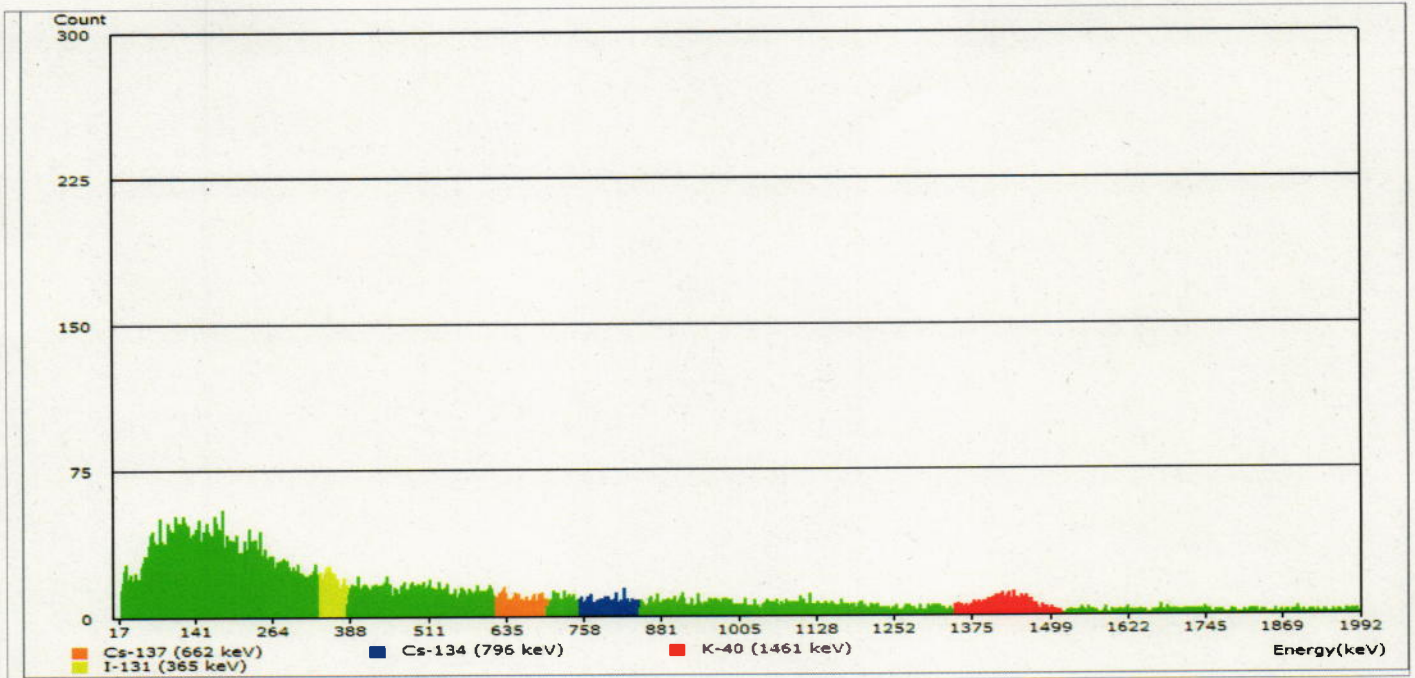

プロトコル情報

サンプル種類 : 多摩小ばと保育園給食

サンプル情報 : 平成27年10月22日

原産地 :

テスト番号 : 2168

カテゴリ : その他

その他 :

プロトコル名 : 給食

プロトコル情報 :

カテゴリ : その他

容器のタイプ : マリネリピーカー 1L

測定時間(秒) : 600

サンプル重量 : 0.965 kg

核種1 : Cs-137

核種2 : Cs-134

核種3 : K-40

核種4 : I-131

核種5 :

核種6 :


測定結果

核種名	エネルギー(keV)	正味計数(count)	放射能濃度(Bq/kg)	検出限界濃度(Bq/kg)	判定基準	判定	
核種1	Cs-137	662	0	N.D.	8.3	25	合格
核種2	Cs-134	796	0	N.D.	8.7	25	合格
核種3	K-40	1461	0	N.D.	19.9	50	合格
核種4	I-131	365	0	N.D.	5.8	50	合格

試料サンプル測定結果

八王子市保健所

測定日付 : 2015-10-22-14:05:27

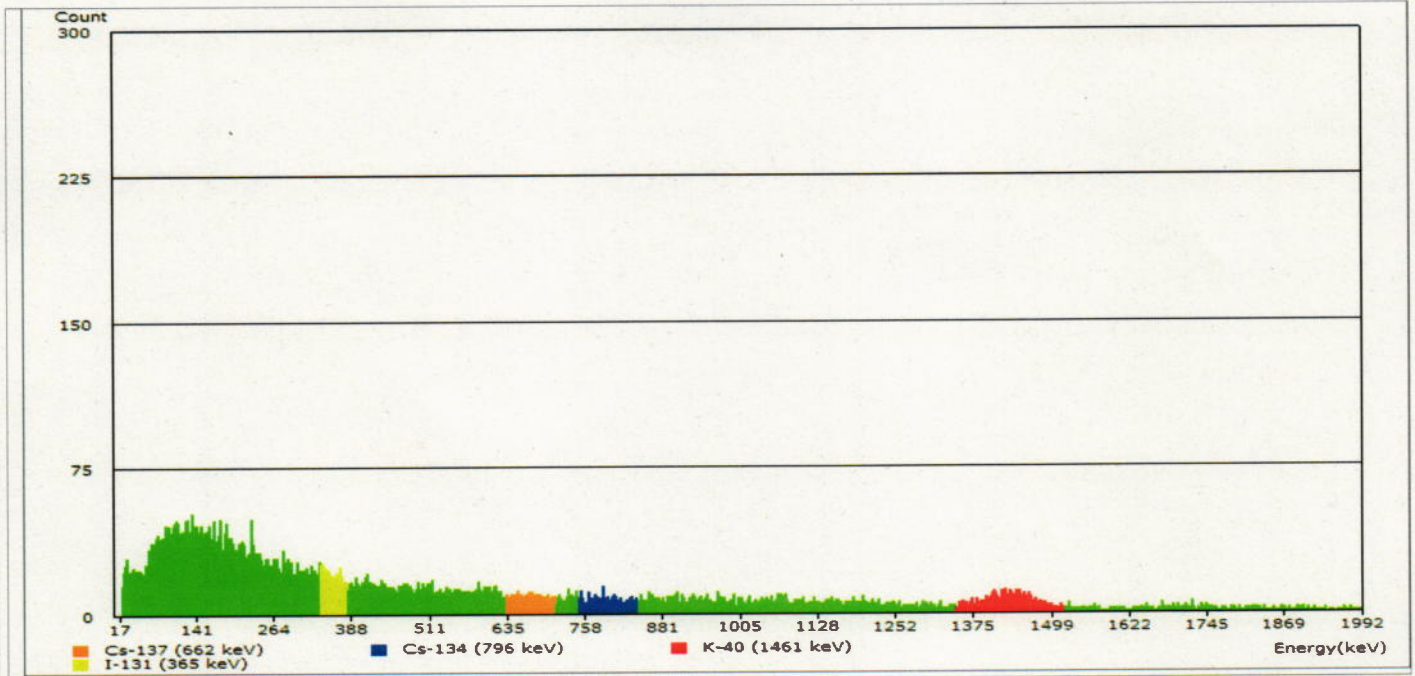

プロトコル情報

サンプル種類 : 多摩小ばと保育園牛乳

サンプル情報 : 平成27年10月22日

原産地 :

テスト番号 : 2169

カテゴリ : 牛乳・乳製品

その他 :

プロトコル名 : 牛乳

プロトコル情報 :

カテゴリ : 牛乳・乳製品

容器のタイプ : マリネリピーカー 1L

測定時間(秒) : 600

サンプル重量 : 0.877 kg

核種1 : Cs-137

核種2 : Cs-134

核種3 : K-40

核種4 : I-131

核種5 :

核種6 :

測定結果

核種名	エネルギー(keV)	正味計数(count)	放射能濃度(Bq/kg)	検出限界濃度(Bq/kg)	判定基準	判定	
核種1	Cs-137	662	0	N.D.	8.3	25	合格
核種2	Cs-134	796	0	N.D.	9.7	25	合格
核種3	K-40	1461	0	N.D.	21.5	50	合格
核種4	I-131	365	0	N.D.	6.3	50	合格